醫用口罩瑕疵檢測

輝榮創研有限公司
新竹縣竹北市科大一路282號
03-6573830 / 03-6573834
websales@huirong.com.tw

Copyright© HUIRONG CORPORATION. All rights reserved.

HuiRong
輝榮創研有限公司

測試環境

硬體配置：

- 相機：
  - 晶片解析：1600 x 1200
  - 像元大小：4.5 um
  - 晶片大小：7.2 x 5.4 mm (1/1.8")

- 鏡頭：HR118-0820
  - 倍率：0.031X
  - 工作距離：260 mm
  - 工作視野：233 x 175 mm

- 光源；特殊光場設計，將口罩表面均勻打光
  - 聯繫我們獲得更多資訊 websales@huirong.com.tw

- 軟體：優化辨識邏輯，使檢測更加準確

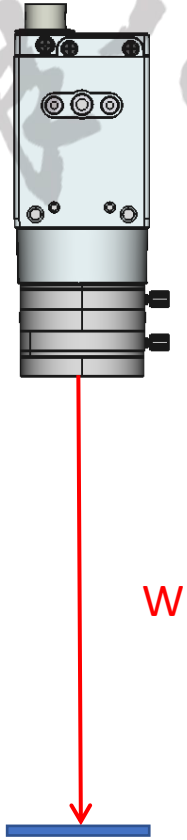

Copyright© HUIRONG CORPORATION. All rights reserved.

實際檢測結果

鼻線外露

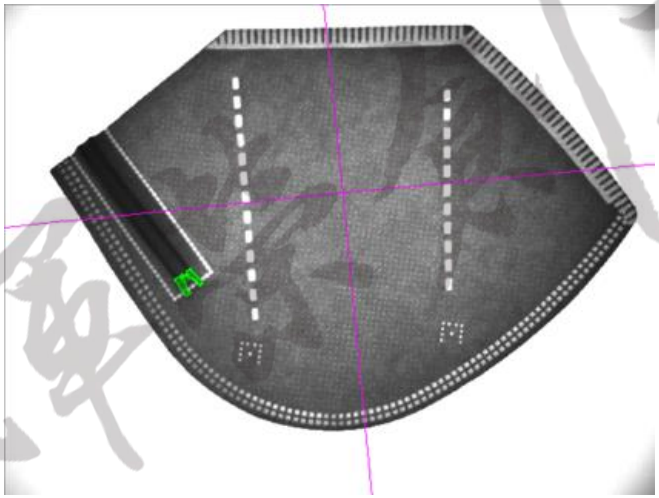

印刷不良

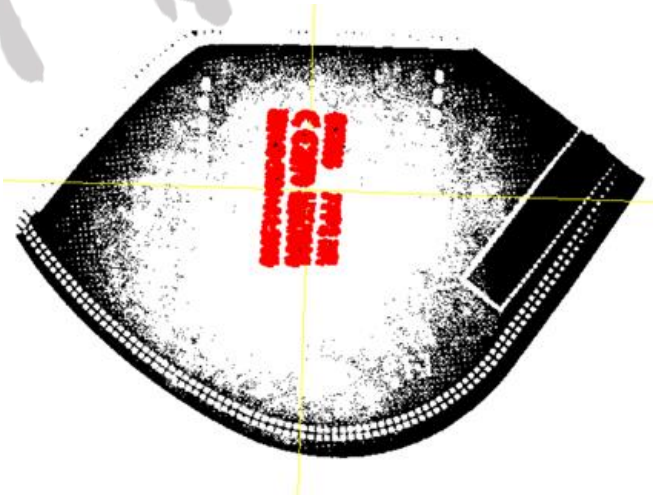

Copyright© HUIRONG CORPORATION. All rights reserved.

HuiRong
輝榮創研有限公司

實際檢測結果

黑點

皺褶

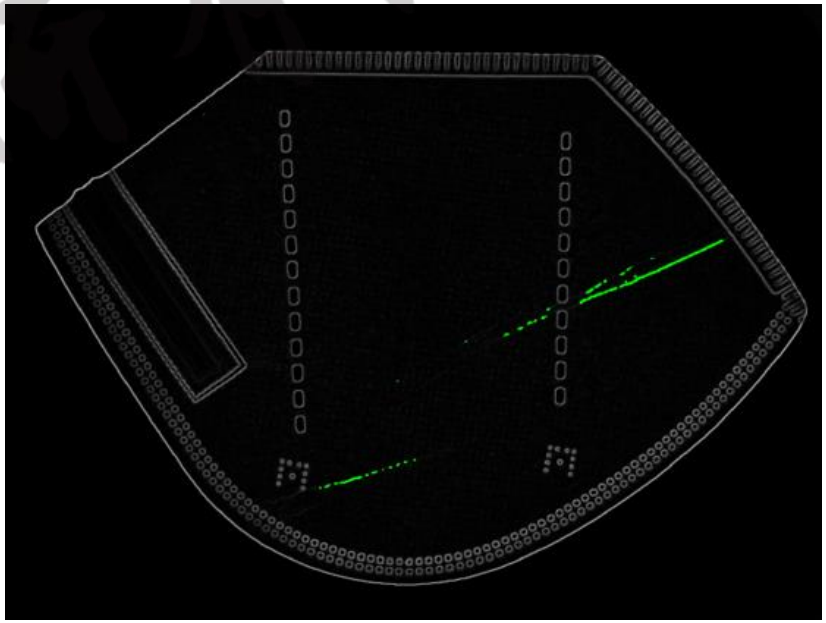

Copyright© HUIRONG CORPORATION. All rights reserved.

HuiRong
煇榮創研有限公司